

CLINWATER T10

Produkt-Nr.: VITARING-712771441233
Plastikkasten, inkl. Wand-Ablage:
Farbe blau, L 210, B 130, H 95 mm,
Füllung: Amethyste, Rosenquarze,
Bergkristalle, u.a. Quarze.
Produktgewicht ca. 2 kg,

Unsere Produkte sind wissenschaftlich
universitär nicht geprüft, deswegen
dürfen wir ihnen keine Wirkung
zusprechen, dies wäre unlauterer
Wettbewerb nach dem UWG.

Bitte kontaktieren Sie uns. Bei Rückgabe
der Produkte innerhalb von vier Wochen
erstatten wir Ihnen den Kaufpreis und die
Portokosten, bitte BLZ und KN, bzw. IBAN
und BIC, angeben. Wir erstatten Ihnen
auch gerne auf Wunsch vorab die
Portokosten.
Bitte nicht "unfrei" zurücksenden - danke!

-VITARING® - biomedsystems GmbH, D-83361 Kienberg / Obb.


Bitte bestellen Sie bei dieser Adresse :




CLINWATER T10

DAS GERÄT FÜR GROSSE
BETRIEBE


Leistung: 10.000 Liter / Tag

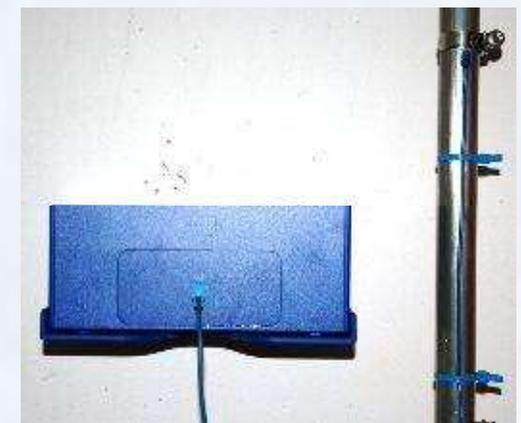

Nachfolgende Bilder zeigen einen Bluttest mit dem
Gerät CLINWATER T10, der am 18.05.2007 durch-
geführt wurde. Acht Tage vor Testbeginn wurde das
Gerät an das Wasserrohr des Trinkwassers
angeschlossen, um die Informationen des
CLINWATER T10 in das Leitungswasser zu über-
tragen. Bei den Probanden wurde bei der
Voruntersuchung eine Blutprobe genommen und
diese mittels der Dunkelfeldmikroskopie
ausgewertet. (nach Prof. Enderlein)
Anschließend trank der Proband 250 ml vom
Leitungswasser. Nach 15 Minuten Wartezeit wurde
bei der Nachuntersuchung eine Blutprobe
genommen und diese mittels der Dunkelfeld-
Blutuntersuchungs-Methode ausgewertet.
Insgesamt nahmen sechs Probandinnen/Probanden
an diesem Test teil.

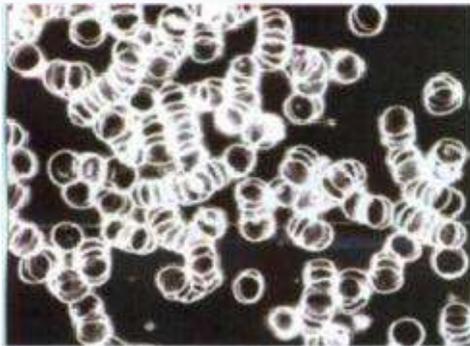

Voruntersuchung

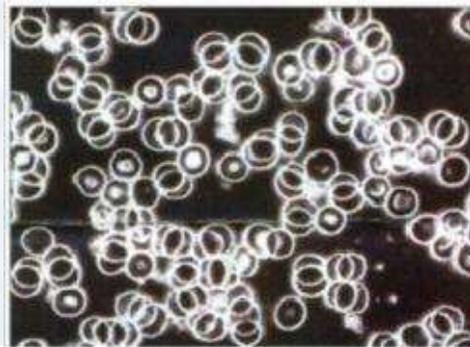

Nachuntersuchung

Die Tests zu den Produkten zeigen signifikante Energieveränderungen, sowie positive Blutbildveränderungen bei den Testpersonen. Diese Tests und ihre Ergebnisse sind als informativ und meinungsbildend anzusehen.

Wir sprechen zu unseren Produkten nur Empfehlungen über die Handhabung aus, und Sie als Kunde testen dann, ob die von Ihnen erwartete Wirkung Ihrer Vorstellung entspricht.

CLINWATER T10 inaktiv

Überlinger Wasser ohne CLINWATER T10
Informationen, Labor Dr. Höffner



CLINWATER T10 aktiv

Wunderschöne kristalline energetische
Strukturen im Überlinger Wasser mit
CLINWATER T10 Informationen,
Labor Dr. Höffner



Zusammenfassung vom 01.12.2005:

CLINWATER T10 bewirkt eine Verbesserung der Kriterien:

Energie, Information, Funktionsstatus und Sol-Gel-Zustand.

Die Ergebnisse sind signifikant bis hoch signifikant. Als Folge der Signifikanzen, die in dieser Studie resultieren, können dem Gerät **CLINWATER T10** zur Behandlung von Leitungswasser positive biologisch-energetische Effekte zugesprochen werden.

Es ist geeignet, die Leitungswasserqualität deutlich anzuheben.

